


De: Laboratório ETE <laboratorio.ete@saecil.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de abril de 2026 13:27
Para: adriano@saecil.com.br
Cc: ete@saecil.com.br
Assunto: RES: Catálogos LOTE 03

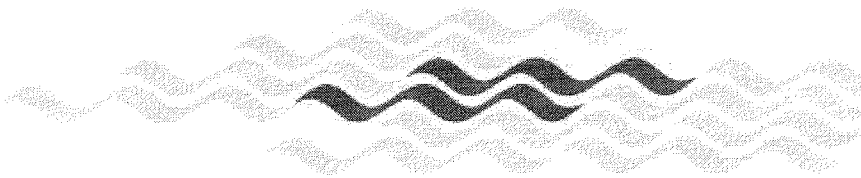

(19) 3573-6200 | 0800-771-6231 • Rua Padre Julião, 971 – Leme, SP • www.saecil.com.br

Boa tarde!

Após análise técnica dos equipamentos ofertados (**Hanna HI98494 e Hanna HI6553-02**), verificou-se que os mesmos **não atende às especificações mínimas exigidas no Termo de Referência**, pelos seguintes motivos:

Item 1- medidor portátil

- O Termo de Referência exige **medidor com 3 canais independentes e medições simultâneas**, enquanto o equipamento ofertado consiste em **sistema com sonda multiparâmetro única**, não caracterizando canais independentes;
- Não possui **entradas independentes para sensores**, conforme exigido, operando com sensores integrados em uma única sonda;
- Apresenta **arquitetura distinta da especificada**, não sendo equivalente ao sistema de sensores digitais independentes previsto no Termo de Referência;
- Não há comprovação de atendimento a requisitos obrigatórios, como **classe de segurança elétrica e condições ambientais completas**.

Dessa forma, conclui-se que o equipamento ofertado **não pode ser considerado equivalente técnico ao modelo de referência**, caracterizando **descumprimento de requisitos mínimos obrigatórios**.

Item 2 – medidor de bancada


- ausência de comprovação de operação com **3 canais independentes e medições simultâneas**;
- não comprovação de compatibilidade com todos os parâmetros exigidos, incluindo **turbidez, pressão parcial e BOD**;
- ausência de comprovação da **capacidade mínima de armazenamento (10.000 medições)**;
- ausência de comprovação de requisitos obrigatórios, incluindo **grau de proteção (IP 43) e funcionalidades operacionais (memória de calibração, timer de calibração, logger interno)**

Dessa forma, conclui-se que os equipamentos ofertados **não pode ser considerado equivalente técnico ao modelo de referência**, caracterizando **descumprimento dos requisitos mínimos obrigatórios**.

At.te
Estevão Alan Vieira

Químico
Estação de Tratamento de Efluentes
(19) 9 9466-4682

De: adriano@saecil.com.br <adriano@saecil.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2026 12:51
Para: laboratorio.ete@saecil.com.br
Assunto: ENC: Catálogos LOTE 03

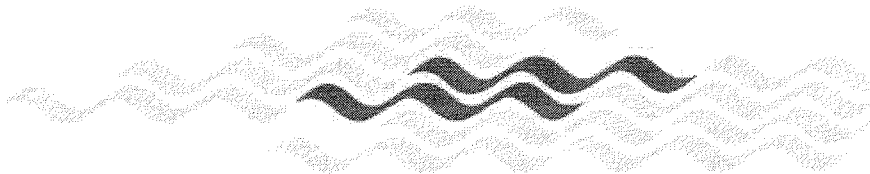

(19) 3573-6200 | 0800-771-6231 * Rua Padre Julião, 971 – Leme, SP * www.saecil.com.br

Estevão,


Apenas complementando a mensagem anterior, o Licitante enviou a seguinte mensagem no chat da plataforma:

“**Participante 733541531** - Obrigado! Apenas para registro, informamos que, em relação ao Item 02 do Lote 03 — Medidor Multiparâmetro de Bancada, referência Multi 9630 IDS —, o modelo de referência foi descontinuado/indisponibilizado comercialmente, conforme informação recebida de fornecedor consultado. Dessa forma, estamos ofertando modelo equivalente/similar, conforme permitido no edital, acompanhado dos respectivos catálogos/fichas técnicas para análise do Setor Requisitante.”

At.te,

Adriano Ciarlariello
Agente Administrativo
SAECIL – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
(19) 3573-6200
www.saecil.com.br

De: adriano@saecil.com.br <adriano@saecil.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de abril de 2026 12:39
Para: 'laboratorio.ete@saecil.com.br' <laboratorio.ete@saecil.com.br>
Assunto: Catálogos LOTE 03

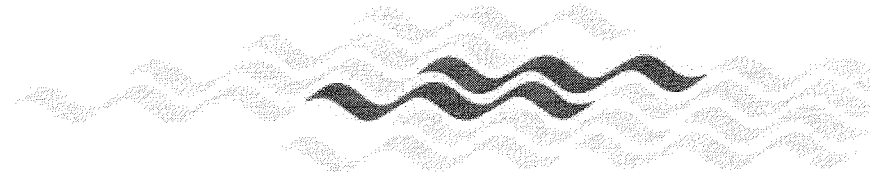

(19) 3573-6200 | 0800-771-6231 * Rua Padre Julião, 971 – Leme, SP * www.saecil.com.br

Prezado, boa tarde.

Encaminho, em anexo, proposta e catálogos dos itens referentes ao LOTE 03 do Pregão Eletrônico nº. 04/2026, para análise e aprovação.

At.te,

Adriano Ciarlariello

Agente Administrativo

SAECIL – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME

(19) 3573-6200

www.saecil.com.br